Archivo: POLVO.paq		Compañía: Datapaq Ltd	
Ubicación: Cambridge	Proceso:	Producto: Gabinete de archivos	Detalles de la recolección de datos:

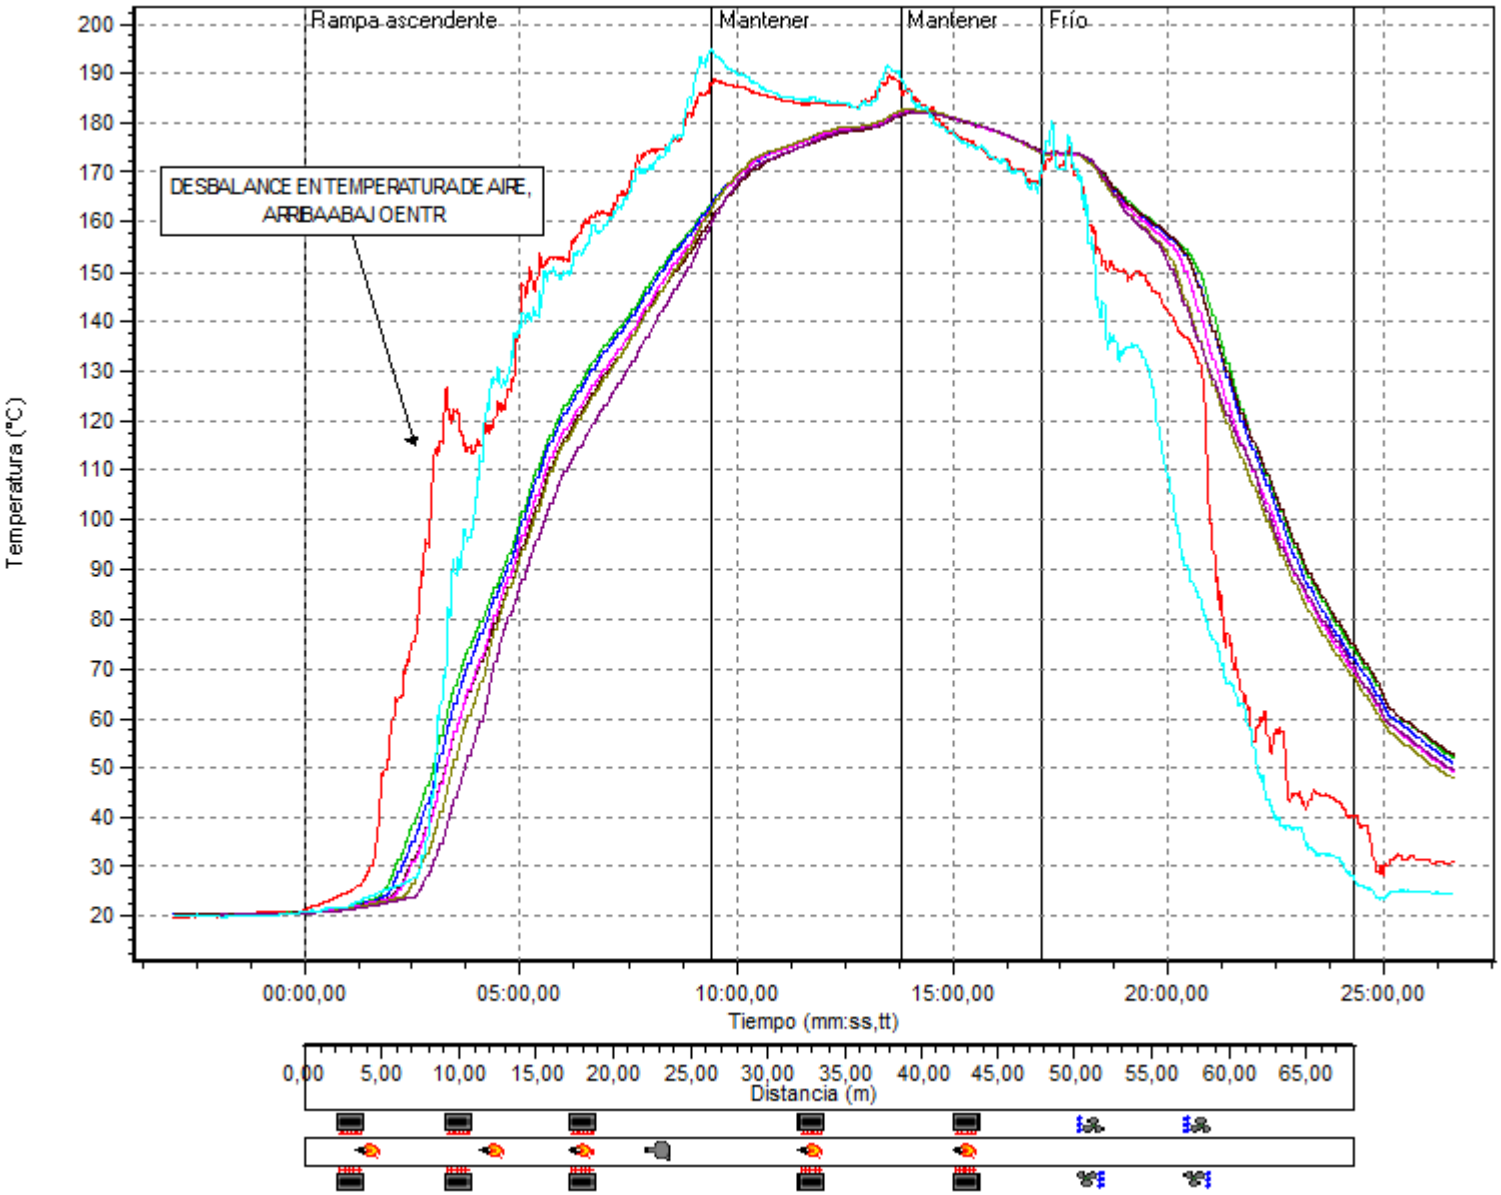

Velocidad de línea:	Zona:	Rampa ascendente	Mantener	Mantener	Frío
2,800 (m/min)	Longitud (m):	26,47	12,25	9,12	20,17
	Punto de ajuste (°C):	0,0	0,0	0,0	0,0

Creado por	Descarga
Número de sondas	8
Intervalo de muestra	0:00,50 (mm:ss,t)
Datos cargados	25/03/2009 11:02:13
Se inició la recolección	25/03/2009 10:30:27
Temp. interna máxima	22,1 °C
Registrador	MemoryPaq XL2
Id de MemoryPaq	#15
Id de Interfaz de transductor	#13
Operario	Steve Offley
Proceso	
Horno	
Receta	Untitled
Producto	Gabinete de archivos
Tiempo impreso	15/11/2018 11:27:04

Notas:

Pieza de prueba - Acero posterior de gabinete

Archivo: POLVO.paq		Compañía: Datapaq Ltd	
Ubicación: Cambridge	Proceso:	Producto: Gabinete de archivos	

Mapa de sondas:

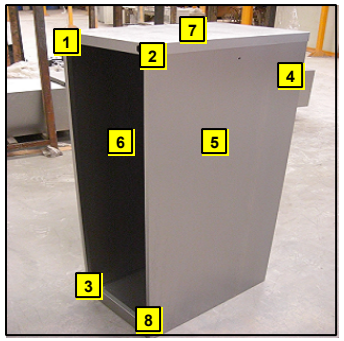

0,10x0,10 m

	x	y
#1	0,08	0,01
#2	0,06	0,02
#3	0,08	0,08
#4	0,01	0,02
#5	0,04	0,04
#6	0,07	0,04
#7	0,04	0,01
#8	0,06	0,10

Dirección de desplazamiento

Sonda 1 - AIRE ARRIBA IZQUIERDA

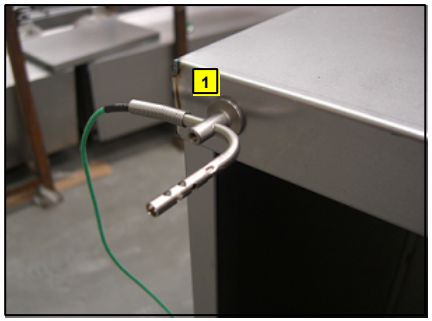

Sonda 2 - METAL ARRIBA DERECHA

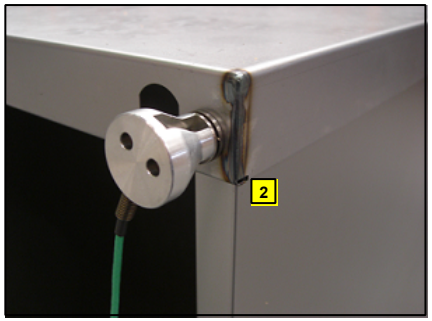

Sonda 3 - METAL LABIO INFERIOR FRENTE

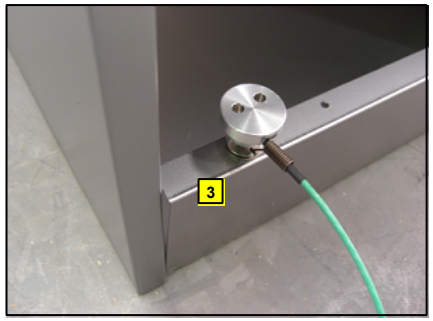

Mapa de sondas:

Sonda 4 - METAL SOPORTE INTERNO

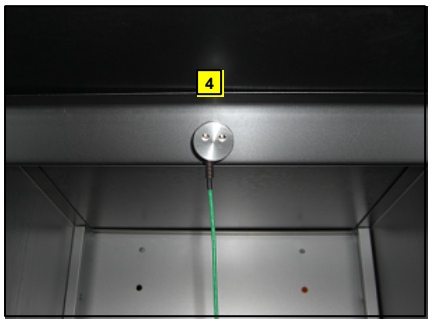

Sonda 5 - METAL LADO DERECHO

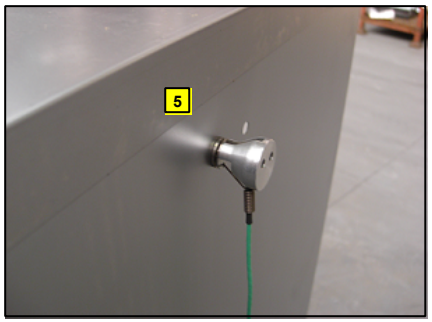

Sonda 6 - METAL LADO IZQUIERDO

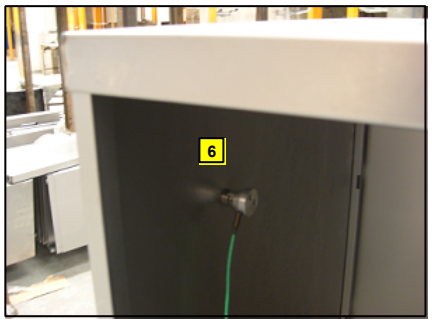

Sonda 7 - METAL TAPA SUPERIOR

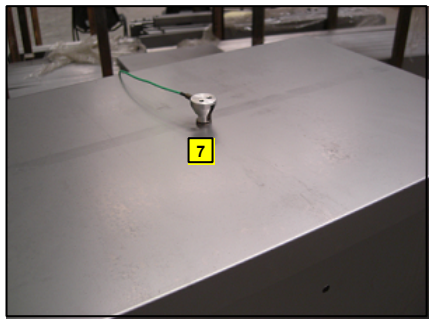

Mapa de sondas:

Sonda 8 - AIRE LABIO INFERIOR FRENTE

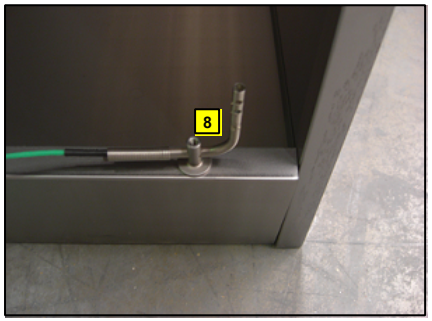

Archivo: POLVO.paq		Compañía: Datapaq Ltd	
Ubicación: Cambridge	Proceso:	Producto: Gabinete de archivos	

Sonda	Valor Datapaq (Plan de curado 1)				Máximo / Mínimo							Tiempo a temperatura		Rampa ascendente
	Temp mín 140,0 Temp máx 220,0°C													Velocidad de rampa (°C/seg)
	170,0°C 15:00,00 (mm:ss,tt)	180,0°C 10:00,00 (mm:ss,tt)	190,0°C 07:00,00 (mm:ss,tt)	Valor Datapaq	Máximo (°C)	Máx. alcanzado (mm:ss,tt)	Media (°C)	Desviación de 0,0°C	Desviación estándar	Mínimo (°C)	Mín. alcanzado (mm:ss,tt)	Tiempo por encima 180,0°C (mm:ss,tt)	Tiempo para alcanzar 180,0°C (mm:ss,tt)	1 00:00,00 a 01:00,00
#1 (°C) AIRE ARRIBA IZQUIERDA	09:48,50	05:56,00	00:00,00	123	189,5	13:33,00	115,1	+189,5	64,8	19,8	-02:58,50	05:56,00	08:49,50	0,76
#2 (°C) METAL ARRIBA DERECHA	08:22,00	02:15,00	00:00,00	98	182,6	13:59,00	114,2	+182,6	59,5	20,3	-02:30,00	02:15,00	13:14,50	0,41
#3 (°C) METAL LABIO INFERIOR FRENTE	08:20,50	02:12,50	00:00,00	97	182,6	13:57,00	113,3	+182,6	59,8	20,4	-03:01,50	02:12,50	13:14,00	0,43
#4 (°C) METAL SOPORTE INTERNO	08:10,00	01:56,50	00:00,00	94	182,1	14:01,50	112,4	+182,1	59,6	20,4	-02:53,00	01:56,50	13:27,00	0,43
#5 (°C) METAL LADO DERECHO	08:16,50	02:06,00	00:00,00	95	182,6	14:01,00	111,6	+182,6	60,2	20,1	-02:54,50	02:06,00	13:18,50	0,44
#6 (°C) METAL LADO IZQUIERDO	08:19,00	02:16,00	00:00,00	94	182,9	13:56,00	110,4	+182,9	60,6	20,1	-02:53,50	02:16,00	13:12,50	0,46
#7 (°C) METAL TAPA SUPERIOR	08:12,00	02:02,00	00:00,00	91	182,3	14:01,00	109,2	+182,3	60,5	20,2	-02:53,00	02:02,00	13:25,00	0,43
#8 (°C) AIRE LABIO INFERIOR FRENTE	09:40,50	05:50,50	01:14,50	121	194,8	09:25,00	107,9	+194,8	68,3	19,9	-01:59,00	05:50,50	08:47,50	1,11

Sonda	Rampa ascendente Curado nominal	Gradientes					Diferencia máxima		
	Tiempo para alcanzar 160,0°C (mm:ss,tt)	Gradiente positivo (°C/seg)	Tiempo alcanzado (mm:ss,tt)	Gradiente negativo (°C/seg)	Tiempo alcanzado (mm:ss,tt)	Gradiente promedio (°C/seg)		Diferencia máxima (°C)	Tiempo alcanzado (mm:ss,tt)
#1 (°C) AIRE ARRIBA IZQUIERDA	06:28,50	2,01	02:55,50	-2,95	20:53,50	0,01	126,4		
#2 (°C) METAL ARRIBA DERECHA	09:05,50	0,59	03:03,50	-0,50	20:57,00	0,05			
#3 (°C) METAL LABIO INFERIOR FRENTE	09:08,50	0,58	03:11,00	-0,50	20:54,50	0,05			
#4 (°C) METAL SOPORTE INTERNO	09:22,50	0,53	03:28,00	-0,46	20:54,00	0,05			
#5 (°C) METAL LADO DERECHO	09:13,00	0,55	03:15,50	-0,52	20:52,00	0,05		88,8	03:16,00
#6 (°C) METAL LADO IZQUIERDO	09:14,50	0,61	04:15,00	-0,48	20:51,00	0,05			
#7 (°C) METAL TAPA SUPERIOR	09:27,00	0,66	04:16,50	-0,48	22:06,00	0,05	37,6		
#8 (°C) AIRE LABIO INFERIOR FRENTE	06:59,00	2,08	03:15,50	-1,49	18:18,50	0,01			

Parámetros de alarma				
	Análisis	Condición de alarma	Límite	Sonda
1	Valor Datapaq	#1: El valor Datapaq es mayor que	140	#1 - #8
2	Valor Datapaq	#1: El valor Datapaq es menor que	70	#2 - #7
3	Rampa ascendente	#1: Máxima es mayor que (°C/seg)	0,50	#2 - #7